

8 Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол.,шт
Преобразователь давления измерительный СДВ-И-1,60-4-20мА-D3427-0605-3-K00	АГБР.406239.001-32	1
Этикетка	АГБР.406239.001-01.00 ЭТ	1
Руководство по эксплуатации	АГБР.406239.001-01 РЭ	*
Методика поверки	МП 16-221-2009	**

* на 100 шт. или в один адрес
** по заказу

9 Свидетельство о приемке

Преобразователь давления измерительный СДВ-И-1,60-4-20мА-D3427-0605-3-K00 зав. № 85027 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий АГБР.406239.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

ОТК
МП **2**

[Подпись]
(личная подпись) Л.М. Асабина (расшифровка подписи) 03 СЕН 2014 (число, месяц, год)

Первичную поверку произвел:

Оптикс
поверительный клеймо

[Подпись]
(личная подпись) М.В. Аверкиев (расшифровка подписи) 04 СЕН 2014 (число, месяц, год)

Справочные данные об изготовителе

ЗАО «НПК ВИП» 620142 г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,145, а/я 5;
Тел./факс: (343) 380-51-56; 380-51-57;
E-mail: info@zaovip.ru; http://www.zaovip.ru



ОКП 438130

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ



СДВ-И-1,60-4-20мА-D3427-0605-3-K00

ЭТИКЕТКА

АГБР.406239.001-01.00 ЭТ

№ 85027

(заводской номер)

1. Основные технические данные

- 1.1 Верхний предел измерения преобразуемого параметра, МПа 1,60
- 1.2 Выходной сигнал 4-20 мА
- 1.3 Предел допускаемой основной погрешности (γ), в % от ДИ: 0,5
- 1.4 Вариация выходного сигнала, в %: 0,25
- 1.5 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, в % от ДИ: 0,15
- 1.6 Диапазон температур измеряемой среды, °С -50 - +125
- 1.7 Напряжение питания постоянного тока, В:
- номинальное 24,0 ± 0,48
- предельные значения 12÷36

1.8 Габаритные размеры: - диаметр, не более, мм 35

- длина, не более, мм 105

1.9 Размер резьбы присоединительного штуцера G 1/2"

1.10 Масса, не более, кг 0,18

1.11 Потребляемая мощность, не более, В·А 1,00

1.12 Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254-96: IP65

1.13 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи соответствуют исполнению:
- по ГОСТ 15150-69 УХЛ категории размещения 1, но для работы при температуре, °С: -50...+80

- по ОСТ 32.146-2000 К6, К7

1.14 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи соответствуют классификационным группам:

- по ГОСТ Р 52931; G2

- по ОСТ 32.146-2000. MMI

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Содержание драгоценных металлов: **РЕМОНТ И ПОВЕРКУ**
Золота, г, не более 0,0045
Серебра, г, не более 0,0375
Титана, г, не более 0,0045
Меди и медных сплавов (латуни), г, не более 1,286;
Олова, г, не более 0,75.

НАЛИЧИИ НАСКОРП
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВЗЛЕТ»
ТЕЛ: (801) 729-21-28, 729-05-59.


2 Указания по эксплуатации

2.1 Назначение выводов соединителя GDM 3009

Контакт	Цепь
1	+U _{пит}
2	Только для подстройки
3	-U _{вых}
4	⊥



2.2 Рекомендуемая схема включения преобразователя

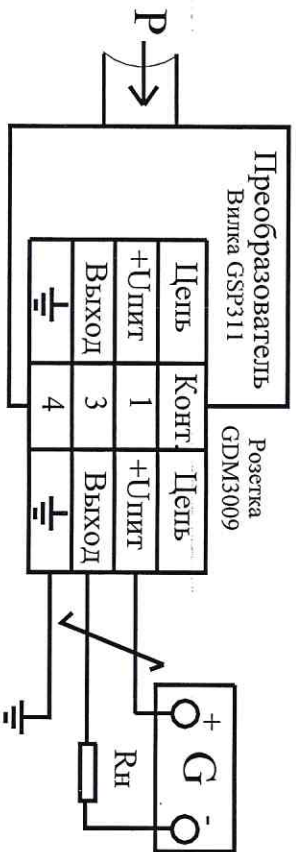

- G - источник питания постоянного тока;
- P - измеряемое (задаваемое) избыточное давление;
- R_н - сопротивляемость нагрузке.

3 Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Срок службы – не менее 14 лет.

3.2 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие преобразователей требованиям АГБР 406239.001ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации (применения), установленных в руководстве по эксплуатации.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей - 3 (три) года с момента (даты) приема преобразователя, указанной в этикетке (паспорте).

3.4 Гарантия не распространяется на преобразователь, с нарушением пломбирования, подвергшийся разборке или любым посторонним вмешательствам в конструкцию изделия или имеющих внешние повреждения конструкции.

3.5 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем при наличии этикетки на преобразователе с отметками о движении изделия в эксплуатации (раздел 4) и сведений о периодических поверках (раздел 5).

3.6 Постгарантийный ремонт преобразователя производится по отдельному договору.

4 Движение изделия при эксплуатации

Дата установ-установки	Где установ-лено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проведшего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

5 Сведения о периодических поверках

Дата поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	Подпись и оттиск мастера поверителя
11.06.17	хорош	10.06.24	В.В.В.В.

6 Краткие записи о ремонте

Дата ремонта	Вид ремонта	Краткие сведения о ремонте	Подпись лица, проводившего ремонт

7 Сведения о сертификации и поверке

7.1. Сертификат РУ.С.30.005.А № 44520 об утверждении типа средств измерений преобразователей давления измерительных СДВ со сроком действия сертификата до 05.12.2016 г.

7.2. Межповерочный интервал – 5 лет.

7.3. Методика поверки – МП 16–221-2009. Допускается поверка в составе аппаратуры, в которую входит преобразователь.

7.4. Результаты поверки заносить в таблицу раздела 5.



11.06
2019